MedPlus®
Surgical solutions

SmartSet® Minor Procedure Kits

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P1060

PAQUETE DE LAPAROTOMÍA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Lapa horizontal	190x240cm	1
Juego de cobertor de mayo	60x135cm	1
Sabana	140x160cm	2
Batas quirúrgicas	130x150cm	3
Toallas	40x30cm	3
Campos quirúrgicos	40x65cm	4
Cubre mesa	140x190cm	1

Materiales Principales

- PE Film 0.05mm
- SMMMS35g , light blue
- woodpulp 50g, white

Embalaje

Enbalaje: 1 set/ pouch, 8sets/case
Tamaño de Caja: 60 x 40 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P1061

PAQUETE COMPLETO DE LAPAROTOMÍA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Lapa estéril	190x240cm	1
Cobertor de mayo	60x135cm	1
Sabana	140x190cm	1
Toallitas	40x30cm	4
Batas quirúrgicas	140x160cm	3
Campos con cintas engomadas	40x65cm	4
Cubre mesa	140x190cm	1
Bolsa de desperdicios	16x31cm	1
Manubrios	/	2
Caucho de succión	30cm	1
Succión de yankauer	/	1

Materiales Principales

- PE Film 0.05mm
- PE Film 50g
- SMMMS35g , light blue
- woodpulp 50g, white
- Paper 57g
- Transparent

Embalaje

Enbalaje: 1 set/ pouch, 8sets/case
Tamaño de Caja: 60 x 40 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P1062

PAQUETE DE LAPAROSCOPIA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Lapa estéril	100x72x120cm	1
Cobertor de mayo	60x135cm	1
Pierneras con agarradero para tubos	80x115cm	2
Batas quirúrgicas	140x160cm	3
Toallas	40x30cm	3
Bolsa de desperdicios	22x33cm	1
campos con cintas engomadas	40x65cm	4
Cubre mesa	140x190cm	1

Materiales Principales

- PE Film 0.05mm
- PE Film 50g
- SMMMS35g , light blue
- woodpulp 50g, white

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch, 8sets/case
Tamaño de Caja: 60 x 40 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P2031

PAQUETE DE PARTO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Bata quirúrgica	140x160cm	2
Pernera	80x122cm	2
Toalla	40x30cm	2
Cubre mesa de instrumentos	152cmx230cm	1
Campo subgluteal	100x110cm	1
Toallas absorbentes	38 cmx56 cm	2
Medio campo	152 cmx112cm	1
Cubre mesa de Mayo	58cmx132cm	1

Materiales Principales

- PE Film 0.05mm
- PE Film 50g
- SMMMS35g , light blue
- woodpulp 50g, white

Embalaje

Enbalaje: 1 set/ pouch,15sets/case
Tamaño de Caja: 65 x 45 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P2041

PAQUETE DE PARTO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Batas de cirujano	140x160cm	2
Pierneras	80x130cm	2
Sabanas plegables	140x160cm	2
Lapa perineal antideslizante	100x110cm	1
Toallas de campo	40x65cm	2

Materiales Principales

•SMMMS35g , light blue

Embalaje

Enbalaje: 1 set/ pouch,15sets/case
Tamaño de Caja: 65 x 45 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P7005

PAQUETE DE NEUROCIRUGÍA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Toallita de mano	30x40cm	2
Batas quirúrgicas	130x150cm	2
Toallas de campo	40x65cm	4
Sabanas	150x240cm	2
Cobertor de mesa de mayo	60x135cm	1
Apósito de incisión	25x25cm	1
Lapa de cabeza	210x270cm	1
Cobertor para mesa de instrumentos	140x190cm	1

Materiales Principales

•SMMMS35g , light blue
• woodpulp 55g, white
• PE Film 0.05mm
• PE Film 50g

Embalaje

Enbalaje: 1 set/ pouch,8sets/case
Tamaño de Caja: 60 x 40 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P5037

PAQUETE DE ARTROSCOPIA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Toallas	30x40cm	2
Batas quirúrgicas	130x150cm	2
Venda elástica	10x475cm	1
Media grande impermeable de pierna	30x120cm	1
Barrera protectora	28x51cm	2
Cobertor de mesa de mayo	60x138cm	1
Lapa en forma de "U"	150x180cm	1
Lapa con bolsa colectora de fluidos de drenaje	200x300cm	1
Cobertor de material impermeable para mesa de instrumentos	140x190cm	1

Materiales Principales

•SMMMS35g , light blue
• woodpulp 55g, white
• PE Film 0.05mm
• PE Film 50g

Embalaje

Enbalaje: 1 set/ pouch,5sets/case
Tamaño de Caja: 52 x 38 x 30cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

SET DE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA

Especificaciones técnicas

Referencia: P4015

Descripción	Talla	Cant.	Material
Batas quirúrgicas AAMI nivel 4	L: 130x150cm	2	SMS
Lapa de Oftalmología, con apertura adhesible bolsa colectora de fluidos	65″ x 95″ Apertura de 1.5″ ; 2.48″	1	SMS
Toallas absorbentes grandes	Los 15″ x 25″	2	SMS
Cobertor de mesa para instrumentos	44″ x 90″ Area de refuerzo de 24″ x 90″	1	Absorbente
Cobertor de mesa de mayo	Los 33″ x 54″	1	Absorbente
Toalla de mano	Los 40x64cm	2	Absorbente

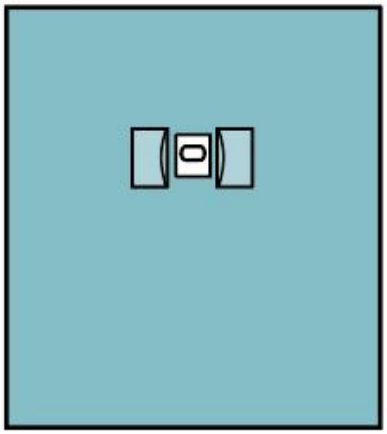

Lapa 65” x 95”

Materiales principales

Material de tacto suave y confortable, que favorece la ventilación y transpirabilidad durante su uso.
Propiedades de absorción y barrera frente a la humedad y líquidos.
Material con características de resistencia a la propagación de la llama.
SMS35g, azul claro, L: 130x150cm, AAMI nivel 4 – Material de acabado suave, confortable al contacto y con características de protección frente a la humedad y exposición a fluidos, facilitando su mantenimiento y limpieza.

embalaje

Embalaje: 1 juego / bolsa, 10 juegos / caja
Tamaño de la caja: 60 x 40 x 40 cm.

Esterilización

Estos productos son estériles con EO

Propiedades

Los estándares de EN 150 13485: 2016 y BS EN 13795-1: 2019.

Información reglamentaria

Producto marcado CE según MDD 93/42 / EEC
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de uso

No lo use si el paquete está dañado
Este producto es solo para un uso y desechar después de su uso.
El campo quirúrgico debe abrirse en la sala de operaciones, en un gran lugar abierto.
Una vez que la cortina esté en contacto con cualquier objeto no esterilizado, debe ser reemplazada.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Información de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor intenso.

Duración

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P2032

PAQUETE QUIRÚRGICO DE CURETAJE Y DILATACIÓN

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Delantales	130x150cm	2
Pierneras	80x115cm	2
Toallas de campo	40x65cm	4
Lapa perineal	100x110cm	1
Sabanita	150x120cm	1

Materiales Principales

•SMMMS35g , light blue

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,12sets/case
Tamaño de Caja: 60 x 40 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

MedPlus®
Surgical solutions

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia K1032 **JUEGO DE ROPA DESECHABLE PARA CAMA DE PACIENTE PATIENT BED SET**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Sabana plana	145x200cm	1
Sabana ajustable	120x200cm	1
Funda para almohada	50x70cm	1

Materiales Principales

•SPP 25g , light blue

Embalaje

Enbalaje: 1 set /PE bag,50sets/case
Tamaño de Caja: 52x 38x 42cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia K2002M, K2002P

CONJUNTO PARA RETIRO DE SUTURAS

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Tijera	11.5cm	1
Pinza de disección	10cm	1
Gasa	7.62x7.62cm-8ply	1

Materiales Principales

- Plastic
- cotton
- carbon steel

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,100sets/case
Tamaño de Caja: 40x 40x 30cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia K1026 **SET DE CURACIÓN DESECHABLE**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
guantes quirúrgicos Nº 7	#7"	2
pinza hemostática Halsted ± Mosquito- Recta	/	1
tijera de Iris	10.8-12cm	1
gasas	10.16 x10.16 cm-4 capas	8
micropore	1" x 24"	1
venda de gasa	diámetro 3"	1

Materiales Principales

•Stainless steel
•Spunlace 30g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,50sets/case
Tamaño de Caja: 52x 38x 42cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia PA1002 **KIT PARA INCISION Y DRENAJE**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Toalla de mano	30x40cm	3
campo abierto	45x45cm	1
una bolsa	26x45cm	1
Gasas	10x10cm-8ply	4
pinza kelly de acero inoxidable	14cm	1
tijera con filo de acero inoxidable	11.5cm	1
mango de bisturí	/	1
bisturí	11#	1
Envoltura	60x60cm	1

Materiales Principales

•Woodpulp 50g
•PP+PE40g
•Cotton
•Stainless steel
•SMMMS 25g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,50sets/case
Tamaño de Caja: 52x 38x 42cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged

This product is only for one-time use and discard

The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia PA1001

BANDEJA DE RECAMBIO DE LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
guantes	Size： L	2 pares
recipientes de remojo	60ml	2
gasas	10x10cm-8ply	8
campo fenestrado	24cm x 24cm	1
grapa	Universal size	1
Envoltura	60x60cm	1

Materiales Principales

•Transparent
•Cotton
•SMMMS 25g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,50sets/case
Tamaño de Caja: 52x 38x 42cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia CP04.07.0044 **BANDEJA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTO EN HEMODINÁMICA**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
cubierta de sabana para cubrir el primer campo	120x200cm	1
cubierta de sabana para proteger la lapa quirurgica	65cm	1
gasa	10x10cm-12ply	20
Jeringa de 2cc	2mL	2
Jeringa de 3cc	3mL	1
Lapa femoral con adhesivo	220x340cm	1
Pocillo	500ml	1
Aguja hipodermica	22G x 2.5cm	1
Batas desechables	140x160cm	2
Aguja hipodermica	18G x2.5cm	1
Cobertor de mesa	18G x2.5cm	1
Pinza hemostatica mosquito	12.7cm	1
Clamp. para sujetar campo	7cm	3
banda para apositos	10x12cm	2
Aguja	21Gx1 1/2	1
Bisturi N° 11	#11	1
Jeringa de 5cc	5ml	1
Toallitas	30x40cm	2

Materiales Principales

•Transparent
•LDPE0.035mm
•Cotton
• SSF 115g
•PP+PE 60g
•Stainless steel
•Woodpulp 50g

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,8sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x45cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia CP04.09.0036

KIT DE MATERIALES PARA CIRUGÍA DE CADERA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
lapa Con bolsa colectora de fluidos	230x330cm	1
lapa en forma de "U" con adhesivo	230x260cm	1
cobertor de mesa de instrumentos	150x200cm	1
cobertor de mesa de mayo	60x135cm	1
batas quirúrgicas con puño de tela	140x160cm	2
toallas de manos	30x40cm	2
campo con adhesivo	180x180cm	1
campo con adhesivo	75x90cm	1
campo con adhesivo	150x240cm	1
cinta adhesiva	10x50cm	1
Media elástica	30x120cm	1
rollo de venda elástica	4”x5yd	1

Materiales Principales

•SMMMS 35g
•PE Film 0.05mm
•PP+PE 60g
•Woodpulp 55g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,6sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x45cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack

Especificaciones Técnicas

Referencia CP04.10.0042

KIT DE MATERIALES PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
lapa	200x350cm	1
lapa en forma de "U" con adhesivo	230x260cm	1
cobertor de mesa de instrumentos	150x200cm	1
cobertor de mesa de mayo	80x140cm	1
batas quirúrgicas con puño de tela	140x160cm	2
toallas de manos	30x40cm	2
campo con adhesivo	150x240cm	1
campo plano	150x180cm	1
cinta adhesiva	10x50cm	1
media elástica	30x120cm	1
rollo de venda elástica	4”x5yd	1

Materiales Principales

•SMMMS 35g
•PE Film 0.05mm
•PP+PE 60g
•Woodpulp 55g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,6sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x50cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia P6012 **SET DE ROPA PARA CITOSCOPÍA**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
cubre mesa de instrumentos con áreas reforzadas	112x230cm	1
bata quirúrgicacon toalla grande	130x150cm,40x30cm	1
pernerascon tobillera	80x115cm	2
campo en forma T	76/213x280cm	1

Materiales Principales

•SMMMS 35g
•Woodpulp 50g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,10sets/case
Tamaño de Caja: 60x 42x32cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia K1063 **SET PARA DEBRIDAMIENTO**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
guantes quirúrgicos	7.0"	1 PAR
toallas de campo	40x52cm	2
pinza de disección	12.5cm	1
pinza hemostática Kelly, recta	14cm	1
tijera Iris, curva	11.5cm	1
mango con bisturí	#11	1
jeringuilla de 20 cc	20ml	1
vasos plásticos medicinales de 60 cc.	60ml	2
gasas simples	10x10cm-8ply	10
Cuenca cuadrada	23x12x5cm	1
envolvimiento	60x60cm	1

Materiales Principales

•SMMMS 25g
•Reinforced paper 65g
•Stainless steel
•Transparent
•Cotton

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,40pouches/case
Tamaño de Caja: 60x 50x32cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged

This product is only for one-time use and discard

The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Especificaciones Técnicas

Referencia K1029 **KIT PARA LACERACIONES**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
campo cerrado de tela no tejida.	30x30cm	1
campo abierto de tela no tejida	30x30cm	1
jeringa descartable de 10 cc a 12 cc.	10mm	1
aguja hipodérmica .	22Gx1.5”	1
Cinco	2”x2”-12ply	5
Cinco	4“x4“-12ply	5
punta impregnada de yodo povidona o aplicador de gluconato de clorhexidina de	10cm	1
vaso medicinal	60ml	1
pinza Halted Mosquito curva de acero inoxidable	12.5cm	1
pinza Adson	12.5cm	1
tijera iris recta de acero inoxidable	11.5cm	1
porta aguja Webster de acero inoxidable	12.7cm	1

Materiales Principales

•Absorbent PP+PE
•Stainless steel

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,100sets/case
Tamaño de Caja: 60x 50x32cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it

Especificaciones Técnicas

Referencia CP04.14.0012 **KIT DE INSUMO PREOPERATORIO**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Coberfor de mesa quirúrgica laminado	99x218cm	1
sábana	89x165cm	1
cubre brazos de la mesa quirúrgica	33x76cm	2
correas con velcro para los brazos	5x82cm	2
cubierta para el cabezero	33x38cm	1
correas con velcro y con sus hebillas para posicionar el cuerpo	10x83cm	2
lampazo plano para trapear	12x37cm	1
bolsa roja	1750ml-2500ml,101cmx101cm	1
bolses transparentes	1750ml-2500ml,101cmx101cm	3
bolsa azul	1750ml-2500ml,94x96.5cm	1
bolsa transparente para cubeta:	41x61cm	1

Materiales Principales

•Absorbent PP+PE
•Stainless steel

Embalaje

Enbalaje: 1 set /PEbag,20bags/case
Tamaño de Caja: 60x 50x32cm

Esterilización

Estos productos no son estériles

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia CP04.14.0013

SET DE ROPA PARA VISITAS

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
bata no estéril nivel 3	/	1
mascarilla	/	1
par de cobertores para zapatos	/	1
gorro para mujer	/	1

Materiales Principales

•Absorbent PP+PE
•Stainless steel

Embalaje

Enbalaje: 1 set /PEbag,80bags/case
Tamaño de Caja: 60x 50x32cm

Esterilización

Estos productos no son estériles

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia CP06.14.0007

SET DE LIMPIEZA PERIANAL DESECHABLE

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Pinza Mota	9.5”	1
Torundas de gasa redondas medianas	Diameter 2.5cm	10
Recipiente plástico de 1200 cc.	1200ml	1
Cubre todo que puede ser utilizado como campo estéril en donde viene envuelto el material del juego	76.2x76.2cm	1

Materiales Principales

•plastic
•cotton

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,100sets/case
Tamaño de Caja: 60x 50x32cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia CP04.07.0046 **KIT DE MATERIALES PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR TORÁCICA**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
cubre mesa de instrumentos	112-180x190-229cm	1
batas quirúrgicas, tamaño extragrande, AAMI 4	140x160cm	4
toallas de mano	30x40cm	4
cubre mesa de mayo	60x135cm	1
campos con cinta adhesiva	40x65cm	12
bolsa de desechos	16x31cm	1
lapa para cirugía cardiovascular y torácica:	281x335x210cm	1
Con un mínimo de cuatro (4) velcros	/	4
tiras dos (2) en cada lado al inicio del área en forma de U.	2.5x14cm	4
Sábanas	180x200cm	3
Sábanas	150x180cm	2
campo para la bandeja de la mesa de mayo sin adhesivo.	60x80cm	1
media grande impermeable de pierna.	/	1

Materiales Principales

•SPP 30g+PE 23g
•SMMMS 35g
•Woodpulp 50g
•paper 57g
•PE Film 0.05mm
•SPP30g+PE30g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,6sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x50cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P0600

JUEGO DE PARTO PRE-HOSPITALARIO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
toalla femenina post parto	/	1
guantes estériles	8#	1
clamps para cordón umbilical.	5cm	2
Gasas estériles	10x10cm	10
bolsa de polietileno con cierre tipo zip.	/	1
perilla para aspiración.	/	1
sabana desechable.	/	1
tijera para corte de cordón umbilical de punta roma.	/	1

Materiales Principales

•Stainless steel
•cotton

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,6sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x50cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia P3026P

BANDEJA PARA ANGIOGRAFÍA CORONARIA Y PERIFERICA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
bolsas plásticas	91.4x121.92cm	2
cobertor	137.16x203.2cm	1
bolsa plástica tipo domo	600ml	1
aguja	18G x 3.81cm	1
aguja	21G x 3.81cm	1
aguja	22G x 3.81cm	1
aguja	25G x 3.81cm	1
bisturí	11#	1
envase de 2 onzas (equivalente a 60 ml)	60ml	1
envase redondo plástico de 16 onzas (500 ml)	500ml	1
envase redondo plástico de 32 onzas (1000 ml)	1000ml	1
envase redondo plástico para los alambres guías de 2500 ml.	2500ml	1
bandeja	22.86x12.70x5.06cm	1
pinza forceps curva	12.7cm	1
gasas	10x10cm	50
toallas	40x60cm	6
clamps para las toallas.	/	4
espátulas con esponja distal	20cm	3
batas quirúrgicas	/	2
cobertor desechable de mesa	127x228.6cm	1
Angiography Drape Femoral/Radial	240x340cm	1
jeringuillas de policarbonato	20ml	3
jeringuillas de policarbonato	10ml	2

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

jeringuillas de policarbonato	10cm	2
dispositivo de seguridad para los objetos punzocortantes (agujas, bisturís)	/	1
juego de Manifold con 3 puertos con rotadores giratorios con	/	1 set
jeringuilla de policarbonato anilladas	10ml	1
llave de tres vías	/	1

Materiales Principales

•plastic
•cotton
•SSF 115g

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,6sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x50cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

BATA PARA MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE CITOTOXICOS

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
MPA1237S	BATA PARA QUIMIOTERAPIA	CHICO
MPA1237M	BATA PARA QUIMIOTERAPIA	MEDIANO
MPA1237L	BATA PARA QUIMIOTERAPIA	GRANDE
MPA1237XL	BATA PARA QUIMIOTERAPIA	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

•SMMMS

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,6sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x50cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Referencia PA8964

JUEGO PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORACICA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Needle/aguia	18G x1 ½	2
Syringe/Jeringa sin aguja	20ml, LS, sin protector	2
Syringe/Jeringa sin aguja	20ml, LL, sin protector	2
Syringe/Jeringa sin aguja	10ml, LL, sin protector	1
Bulb Syringe/ jeringuilla bulbo para irrigación	60ml, con tapa	2
Ring Basin/Bacín circular	48 oz	2
Ring Basin/Bacín circular	32 oz	2
Medical Cup with cover/contenedores de muestras	120ml, con tapa y etiqueta	2
Blade/láminas quirúrgicas	#11, acero inoxidable	3
Blade/láminas quirúrgicas	#15, acero inoxidable	3
Blade/láminas quirúrgicas	#23, acero inoxidable	3
Cautery Tip Polisher/ limpiador de puntas de cauterio	4.5x4.5x0.5cm, detectable por rayos X	1
Utility Drape/toallas no absorbentes, con adhesivo	40x65cm, para delinear el sitio quirúrgico	6
Woodpulp Hand Towel/Toallas secado campo	41x31cm, absorbentes, blanco	4
OR Towel/toallas de algodón	44x61cm, azul, no-rayos-X, libre de pelusa	5
Surgical Drape/Paño superior	190x200cm	1
Perineal Drape/ Paño perineal	200x190cm, con aislamiento de la región perineal	1
Light Handle Cover/ cobertor de agarradero de lampara	/	3
Back Table Cover/ Cubre mesa	153x230cm,calidad premium,conabsorción superior,impermeabilidad,transpirabilidad y resistencia al fuego.	1

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Back Table Cover/Cubre mesa	181x225cm, polipropileno de alta resistencia, con doble capa textil.	1
Mayo Stand Cover /Cobertor de Mesa de Mayo	60x140cm	1
Lab Sponge/almohadilla abdominal	Algodón, 40s/25x17 mallas, prelavado, con lazo,18x18¨-4ply, radiopaco	8
Lab Sponge/almohadilla abdominal	8x15¨-4ply	4
Cardiovascular Drape/Campo Cardiovascular	281x335x210cm, división con bolsillo y velcro, con cabezal de material transparente.	1
lazos identitentes, vasculares/Anillo identificador vascular de silicona	16", azul, rayos-X	2
lazos identitentes, vasculares/Anillo identificador vascular de silicona	16", rojo, rayos-X	2
Instrument Pouch/bolsillo para instrumentos con adhesivo	50x45cm	1
Needle Counter/Contadores de agujas	11.4*5.5*1.4cm, marcado para hasta 30 agujas.	1
Suction Tube/tubo de succión	7mmx12ft, libre de látex	1
Yangkauer Bulb Tip/succión, yankauer	Punta recta abierta, sin orificios de ventilación	1
Surgical Gown AAMI 4/Bata quirúrgica estándar AAMI 4	130x150cm, tamaño grande	3
Surgical Gown AAMI 4/Bata quirúrgica estándar AAMI 4	140x160cm, tamaño extragrande	1
Label set//Hoja de etiquetas	½ x2	1
Ruler/ regla	6¨, flexible	1
Skin Marker/marcador de piel	0.5mm/1mm, punta doble violeta, apta para uso en piel y para marcar etiquetas.	1
Tray/bandeja	31x24x7cm para la transferencia de seguridad color azul	1
Tray/bandeja	45x30x2cm, de mayo plástica, pequeña	1

Materiales Principales

- PP20ml, transparente
- pc10ml, transparente
- PP37g, azul

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

- PP31g, azul
- PP17g, transparente
- SMMMS35g, azul
- Woodpulp 50g, blanca
- PE Film 50g+28g spp, azul
- SPP30g+PE30g, azul
- PE Film 0.05mm, azul
- Laminado absorbente 55g, azul
- PE Film 0.07mm, transparente
- BVB64g, azul
- pp95g, azul

Embalaje

Enbalaje: 1 set /pouch,2sets/case
Tamaño de Caja: 60x 40x40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Laceration Kit

CE

Technical specifications

Reference K1012P

Description	Size	Qty
Tray/Bandeia	El 19.7x10.7x2.6 cm	1
Mosquito Hemostatic curve/Pinza Halted mosquito	Acero inoxidable,12.5 cm de longitud curva	1
Webster needle holder/Porta agujas Webster	Acero inoxidable,5” de longitud	1
Adson Forcep/Fórceps de Adson	Acero inoxidable,1X2 dientes,12 cm	1
Iris Scissor/Tijera Iris	Acero inoxidable,12.5 cm de longitud, RECTA	1
Syringe/Jeringuilla	tamano 10ml, Bloqueo Luer	1
Needle/Aguia	22Gx1.5 "(1 1/2)	1
Non-woven Drape/Campo cerrado	PP+ PE absorbente, azul claro 30x30cm,Tela no tejida	1
Non-woven Drape with Hole/Drapeado con agujero	PP + PE absorbente, azul claro,30x30cm，con agujero:dia=6cm, Tela no tejida	1
Povidone-Iodine Swabsticks/Hisopo de Yodo povidona	Bastoncillos de PVP , Punta de algodón 3pcs en una bolsa	1
Gasa	4 "x 4" -12ply , H doblado	5
Gasa	2 "x2" -12ply	5
medicine cup/taza de medicina	60ml	1
Wrapping/Envase	Papel + PE, azul claro, Los 50x50cm	1

Main Materials

- Plastic
- Metal
- PVP
- Cotton
- PP+PE

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

- Paper

Packaging
Packing: 100pc/carton

Sterilization
These products are EO sterile

Properties
The standards of EN 150 13485:2016 and BS EN 13795-1:2019.

Regulatory Information
Product CE marked as per MDD 93/42/EEC
Directive on Medical Devices. Class of the device: Is.
Conformity Assessment Route: Annex V

Precautions for Use
Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard after use
The surgical drape must be opened in the operation room, in a big open place.
Once the drape in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

Storage Information
Store in a dry and cool place, away from intense sources of heat.

Shelf Life
5 years

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **Cubierta de zapato antideslizante**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A5002	Cubierta de zapato antideslizante	Tamaño Universal
A5001	Cubierta de zapato antideslizante	Tamaño Universal

Materiales Principales

•SPP35g
•SMS35g

Embalaje

Enbalaje: 100pcs/bag, 10bags/case
Tamaño de Caja: 44x 32x30cm

Esterilización

Estos productos no son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

SET PARA REMOVER PUNTOS DE SUTURA

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
K2002	SET PARA REMOVER PUNTOS DE SUTURA	PINZA DE METAL
K2002P	SET PARA REMOVER PUNTOS DE SUTURA	PINZA DE PLÁSTICO

Materiales Principales

- cotton
- carbon stee
- iron

Embalaje

Enbalaje: 1set/pouch,100sets/case
Tamaño de Caja: 40x40x30cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **BATA QUIRURGICA ESTERIL, AAMI NIVEL 4**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
G1017	BATA QUIRURGICA ESTERIL, AAMI NIVEL 4	MEDIANO
G1018	BATA QUIRURGICA ESTERIL, AAMI NIVEL 4	GRANDE
G1019	BATA QUIRURGICA ESTERIL, AAMI NIVEL 4	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

• SMS43g

Embalaje

Enbalaje: 1 pc/pouch,50 pcs/case
Tamaño de Caja: 60x40x40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **BATA QUIRURGICA ESTERIL AAMI NIVEL-2**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
G1010	BATA QUIRURGICA ESTERIL AAMI NIVEL-2	MEDIANO
G1011	BATA QUIRURGICA ESTERIL AAMI NIVEL-2	GRANDE
G1012	BATA QUIRURGICA ESTERIL AAMI NIVEL-2	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

- SMS35g
- SMS40g

Embalaje

Enbalaje: 1 pc/pouch,50 pcs/case
Tamaño de Caja: 60x40x40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **BATA QUIRURGICA ESTERIL,AAMI NIVEL 3**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
G1002	BATA QUIRURGICA ESTERIL,AAMI NIVEL 3	MEDIANO
G1003	BATA QUIRURGICA ESTERIL,AAMI NIVEL 3	GRANDE
G1004	BATA QUIRURGICA ESTERIL,AAMI NIVEL 3	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

• SMS35g

Embalaje

Enbalaje: 1 pc/pouch,50 pcs/case
Tamaño de Caja: 58x38x41cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **Gorra quirúrgica**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A4025	Gorra quirúrgica	Tamaño Universal
A4027	Gorra quirúrgica	Tamaño Universal

Materiales Principales

• SMS35g

Embalaje

Enbalaje: 100pcs/bag, 10bags/case
Tamaño de Caja: 43x33x28cm

Esterilización

Estos productos no son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **BATA PARA PACIENTEBATA**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A2114	BATA PARA PACIENTEBATA	PEQUENO
A2115	BATA PARA PACIENTEBATA	MEDLANO
A2116	BATA PARA PACIENTEBATA	GRANDE
A2117	BATA PARA PACIENTEBATA	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

- SMS35g
- SMS40g
- SPP38g

Embalaje

Enbalaje: 10pcs/bag,12bags/case / 10pcs/bag,10bags/case

Esterilización

Estos productos no son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESIERI AAMINIVEL 2**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A0972	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESIERI AAMINIVEL 2	PEQUENO MATERIAL DE TELA SMMMS
A1072	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESIERI AAMINIVEL 2	MEDIANO MATERIAL DE TELA SMMMS
A1172	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESIERI AAMINIVEL 2	GRANDE MATERIAL DE TELA SMMMS
A1272	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESIERI AAMINIVEL 2	EXTRA GRANDE MATERIAL DE TELA SMMMS

Materiales Principales

- SPP28g
- SMS35g

Embalaje

Enbalaje: 10pcs/bag, 10bags/case
Tamaño de Caja: 52x38x30cm

Esterilización

Estos productos no son estériles

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL. AAMI NIVEL 3**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A0973	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL. AAMI NIVEL 3	PEQUENO.(MATERIAL DE TELANO TEJIDA SMMMS)
A1073	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL. AAMI NIVEL 3	MEDIANO, MATERIAL DE TELANO TEJIDA SMMMS
A1173	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL. AAMI NIVEL 3	GRANDE,(MATERIAL DE TELANO TEJIDA SMMMS)
A1273	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL. AAMI NIVEL 3	EXTRA GRANDE,(MATERIAL DETELA NO TEJIDA SMMMS)

Materiales Principales

- SPP28g
- SMS40g

Embalaje

Enbalaje: 10pcs/bag, 8bags/case(A1173) / 10pcs/bag, 10bags/case
Tamaño de Caja: 52x38x30cm

Esterilización

Estos productos no son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL, AAMI NIVEL 4**

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A0974	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL, AAMI NIVEL 4	PEQUERO (CHICO)
A1074	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL, AAMI NIVEL 4	MEDLANO
A1174	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL, AAMI NIVEL 4	GRANDE
A1274	BATA DESECHABLE PARA USO GENERAL NO ESTÉRIL, AAMI NIVEL 4	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

- SPP28g
- PP+PE 31g

Embalaje

Enbalaje: 10pcs/bag, 10bags/case

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Esterilización

Estos productos no son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas

Guante de examen de nitrilo

Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A7013	Guante de examen de nitrilo	CHICO
A7014	Guante de examen de nitrilo	MEDLANO
A7015	Guante de examen de nitrilo	GRANDE
A7016	Guante de examen de nitrilo	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

• textured surface

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Embalaje
Enbalaje: 100pcs/box, 10boxes/case

Esterilización
Estos productos no son estériles EO

Propiedades
Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria
Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE
Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.
Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso
No utilizar si el embalaje está dañado
Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo
El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.
Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento
Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use
Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **Gorra bouffant / Gorra de copa suelta**
Referencia

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A4001	Gorra bouffant	18"
A4002	Gorra bouffant	21"
A4011	Gorra bouffant	21"
A4017	Gorra de copa suelta	18"

Materiales Principales
• SPP12g

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

• SPP18g

Embalaje

Enbalaje: 100pcs /bag, 20bags/carton / 100pcs /bag, 10bags/carton
Tamaño de Caja: 60x24x25cm

Esterilización

Estos productos no son estériles

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas **JUEGO DE ROPA PARA MÉDICO**

Referencia	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
A2002	JUEGO DE ROPA PARA MÉDICO	CHICO
A2003	JUEGO DE ROPA PARA MÉDICO	MEDIANO
A2004	JUEGO DE ROPA PARA MÉDICO	GRANDE
A2005	JUEGO DE ROPA PARA MÉDICO	EXTRA GRANDE

Materiales Principales

- SMS35g

Embalaje

Enbalaje: 1set/bag, 50sets/case
Tamaño de Caja: 52x38x30cm

Esterilización

Estos productos no son estériles

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: I.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

CE

Especificaciones Técnicas PAQUETE DE CESAREA

REF: PA0615

Descripción	Tamaño	Cantidad
Cubierta de mesa para instrumento	Campo de película de polietileno (PE) de 50 g, dimensiones 150×200 cm, con refuerzo.	1
Campo Quirúrgico para cesarea	SMS de 43 g, color azul claro, forma de "T", 260x200×305 cm, con película adhesiva para incisión de 33x38cm, bolsa recolectora de líquidos y sujetadores para tubos, fenestrada.	1
Bata quirúrgica reforzada	Bata quirúrgica reforzada de SMS de 45 g, nivel de protección AAMI 4, color azul claro, talla XL (140 × 160 cm), con refuerzo, sellado electrónico en áreas críticas, sin costuras.	2
Bata quirúrgica reforzada	Bata quirúrgica reforzada de SMS de 45 g, nivel de protección AAMI 4, color azul claro, talla L (130×150 cm), con refuerzo, sellado electrónico en áreas críticas, sin costuras.	2
Toallas para manos	Toalla para manos de celulosa absorbente 50 g, color blanco, plegada en cuatro partes (1/4). 30x34cm	4
Campo lateral	Campo lateral estéril de SMS de 43 g, color azul claro, dimensiones 75 × 90 cm, con banda adhesiva.	4
Campo quirúrgico multipropósito	Campo quirúrgico multipropósito de SMS de 43 g, color azul claro, dimensiones 150 × 200 cm.	2
Cubierta para mesa Mayo	Funda estéril para mesa Mayo de película de polietileno (PE) de 0,05 mm de espesor, color azul, dimensiones 60 × 140 cm, con refuerzo.	2

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Compresa de maternidad	Compresa de maternidad de 28 × 13 cm, fabricada en tela no tejida y pulpa de madera absorbente de 11,25 g, color blanco, sin alas.	2
Pinza para cordón umbilical	Pinza para cordón umbilical de 5 cm, fabricada en polietileno (PE), color blanco, tipo J, con cierre de una sola traba.	1
Manta para bebé	Manta para bebé de tela no tejida Spunlace de 45 g, color blanco, dimensiones 76 × 86cm.	1
Bolsa para suturas	Bolsa para suturas de 16 × 31 cm, fabricada en papel de 57 g, color blanco, con dos tiras adhesivas de papel de 2,5 × 5 cm ubicadas en la parte superior de la bolsa.	1

Materiales Principales

- Película de polietileno (PE) 50 g
- Tela no tejida SMS 43 g
- Tela no tejida SMS 45 g
- Papel 57 g
- Pulpa de madera 50 g
- Tela no tejida + algodón de pulpa de madera 11.25 g
- Tela no tejida Spunlace 45 g
- Estéril

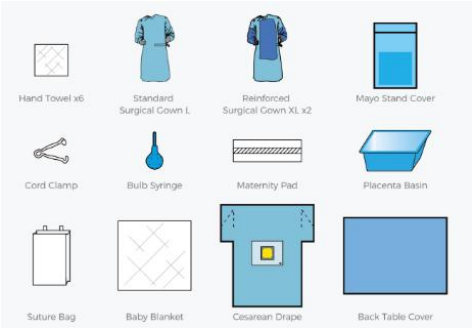

Empaque

1 juego por bolsa de Tyvek

Información Regulatoria

El producto posee marcado CE de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a los productos sanitarios (MDR). Clasificación del dispositivo médico: Clase Is.

Precauciones de Uso

No utilizar si el envase o empaque está dañado.
Producto de un solo uso. Desechar después de su uso

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de fuentes directas o intensas de calor.

Vida Útil

Vida útil: 5 años.
Producto estéril.

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Jiangsu Medplus Non-woven Manufacturer Co., Ltd.
No.217 Wencheng East Road Economic Development Zone Siyang, Jiangsu 223700, China
Tel: +86-21-50132506 Web: www.cnmedplus.com Email: info@cnmedplus.com

BANDEJA PARA ANGIOGRAFÍA

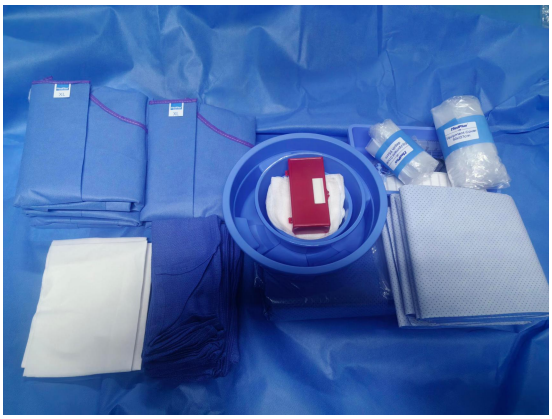

Especificaciones Técnicas

REF: P0244P

Descripción	Tamaño	Cantidad
Cobertor para equipo	91x127cm, transparentes con cinta	2
Sábana de polietileno (PE)	137x228cm, transparente	1
Cobertor para equipo	depth 55cm, transparente	1
Aguja	18Gx3.8cm	1
Aguja	21Gx3.8cm	1
Aguja	22Gx3.8cm	1
Aguja	25Gx3.8cm	1
Bisturí	11#	1
Copa médica	60ml	1
Tazón	500ml	1
Riñonera (bandeja renal)	1000ml	1
Recipiente para guía (Guidewire Basin)	2500ml	1
Tazón rectangular	22x12x5cm	1
Pinza mosquito curva	12cm	1
Toalla quirúrgica	43x60cm	6
Pinza para campos (Backhaus)	7cm	4
Bata quirúrgica estándar	XL:140x160cm	3
Toalla para manos	39x56cm	3
Cobertor para mesa de instrumental (Back Table Cover)	152x228cm	1
Campo para angiografía	240x380cm, radial y femoral con 4 agujeros	1
Campo quirúrgico	111x152cm, medio cuerpo	2
Hoja de etiquetas	45mmx13mm	1
Aguja introductora	18Gx2.7", tipo Seldinger Angiografica	1
Jeringa	20ml	3
Jeringa	10ml	4
Jeringa	5ml	1
Llave múltiple (Manifold)	180°, 3 vías, 500psi	1
Contador de agujas	10x10cm-12ply	5
Contador de agujas	20#	1

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.

Materiales de fabricación

- Acero inoxidable.
- Material transparente.
- Polipropileno (PP) de 16 g/m².
- Polipropileno (PP) de 26 g/m².
- Polipropileno (PP) de 36 g/m².
- Polipropileno (PP) de 95 g/m².
- ABS de 5 g.
- Algodón de 53 g.
- Película de polietileno (PE) de 0.05 mm de espesor.
- Tela no tejida SMS de 43 g/m².
- Pulpa de madera (Woodpulp) de 50 g/m².
- Tela no tejida SSF de 115 g/m².
- Tela no tejida SSF de 95 g/m².
- Polipropileno (PP).

Empaque

Empaque individual estéril: 1 set por bolsa de Tyvek®.

Información regulatoria

Producto con marcado CE conforme al Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios (MDR).
Clasificación del dispositivo médico: Clase Is (estéril).

Precauciones de uso

No utilizar el producto si el empaque está dañado o abierto.
Producto estéril de un solo uso. Desechar después de su utilización.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida útil

5 años.
Producto estéril.

Medidas

Lapa

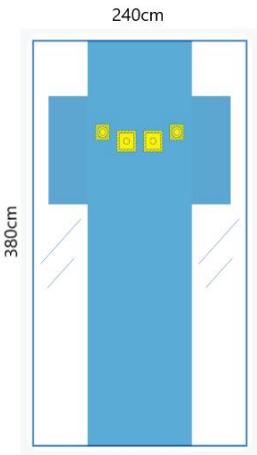

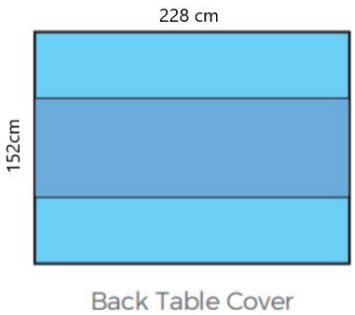

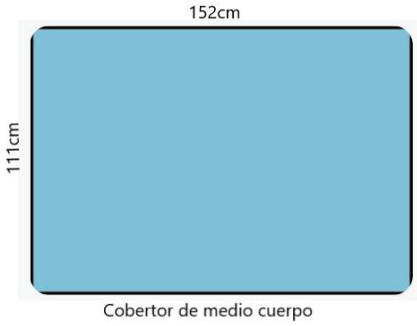

The dimensions and properties listed above can vary within pre-established specifications. This document was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.